

LOKALE DYNAMISCHE MIKROMASSAGE

Dr.rer.nat.habil. Ilja Kruglikov, WELLCOMET GmbH, Karlsruhe, Deutschland

EINFÜHRUNG

Ultraschall mit seinen vielseitigen mechanischen, thermischen und chemischen Wirkungen auf Zellen und Gewebsstrukturen findet schon seit langem verschiedene Anwendungen in der Medizin und in der Ästhetik.

Weder mit Händen noch mit irgendwelchen apparativen Methoden (wie z.B. Vakuummassage oder Vakuum-Kompressions-Massage) können im Gewebe solche gigantischen Druckschwankungen (mehrfach höher als der atmosphärische Druck) in so einem kleinen Raum (in der Größenordnung von ca. 1 mm) erreicht werden. Bei einer konventionellen Vakuummassage werden die 100fach bis zu 1000fach niedrigeren Unterdruckwerte verwendet. Und dabei ist dies alles nicht nur effektiv, sondern auch ungefährlich, was die Anwendungen von LDM sowie in der Medizin als auch in der Kosmetik ermöglicht.

Dieser starke Mikromassageeffekt des Ultraschalls kann noch weiter durch die LDM-Technologie erhöht werden. **LDM – Lokale Dynamische Mikromassage** – ist eine neue Behandlungsmethode, welche sich qualitativ von anderen Massagearten unterscheidet. In der LDM-Technologie werden spezielle Ultraschallwellen benutzt, dessen Frequenzen mit einer großen Geschwindigkeit geändert werden. Dadurch entstehen Effekte, welche mit einem konventionellen Ultraschall nicht erzielt werden können.

WAS BEWEGT DER ULTRASCHALL IM KÖRPER?

Um die Unterschiede zwischen der LDM-Technologie und dem konventionellen Ultraschall zu erklären, müssen zuerst solche Parameter wie Schwankungsamplituden, Geschwindigkeiten und Beschleunigung von Teilchen im Medium wo sich die Ultraschallwellen ausbreiten, sowie die Druckwerte, die sie erzielen, analysiert werden.

SCHWANKUNGSAMPLITUDEN

Ultraschallwellen breiten sich in einem wasserreichen Medium mit einer Geschwindigkeit von ca. 1500 m/s aus.

Die *Schwankungsamplituden* von Mediumsteilchen sind von der Schallintensität und Frequenz abhängig. Bei einer für die kosmetischen Ultraschallbehandlungen üblichen Intensität von 1 W/cm^2 und Ultraschallfrequenz von $1 \text{ MHz} = 10^6 \text{ Hz}$, werden die Teilchen des Mediums mit einer Amplitude von ca. $0,018 \text{ }\mu\text{m} = 0,000018 \text{ mm}$ schwanken.).

Zum Vergleich.

Typischer Durchmesser einer Zelle ist ca. $10 \text{ }\mu\text{m}$ und eine Zellmembran ist lediglich $0,005 \text{ }\mu\text{m}$ dick. Die Schwankungsamplituden von einem Mediumsteilchen sind damit *viel kleiner als die Zelle selbst und viel größer als die Zellmembran*. Das letzte ist ein Hinweis dafür, dass man die Membraneffekte (z.B. die Durchlässigkeit der Zellmembran) durch Ultraschall verändern kann. Es wurde tatsächlich eine Durchlässigkeitssteigerung der Zellmembran bis auf 200 % registriert.

Die Schwankungsamplitude sinkt mit steigender Frequenz wie

$$a = \frac{1}{2\pi f} \left(\frac{2I}{\rho c} \right)^{1/2}$$

hier a ist die Schwankungsamplitude, f ist die Ultraschallfrequenz, I ist die Ultraschallintensität, ρ ist die Mediumsdichte und c ist die Schallgeschwindigkeit.

Dies bedeutet, dass bei einer Frequenz von 3 MHz die Schwankungsamplituden 3fach kleiner als bei 1 MHz werden. Bei einer Frequenz von 10 MHz sind diese Amplituden um das 10fache kleiner, betragen lediglich $0,0018 \text{ }\mu\text{m}$ und werden somit sogar kleiner als die Zellmembran.

GESCHWINDIGKEIT UND BESCHLEUNIGUNG

Maximale *Geschwindigkeit*, welche die Teilchen des Mediums in so einem Ultraschallfeld erreichen können, liegt lediglich bei ca. 10-15 cm/s. Diese Geschwindigkeit ist viel kleiner als die Geschwindigkeit des Schalls selbst. Sie bleibt allerdings nicht konstant und wird ständig von 0 bis auf den oben genannten maximalen Wert geändert.

Dabei entsteht eine *Beschleunigung*, welche an der Spitze bei oben genannter Intensität von 1 W/cm² und einer Frequenz von 1 MHz den Maximalwert von ca. 725 km/s² erreichen kann.

Zum Vergleich.

Wenn ein Auto von 0 auf 100 km/Std in 10 Sekunden beschleunigt wird, entsteht eine Beschleunigung von nur ca. 0,003 km/s².

So eine ungleichmäßige Bewegung im Gewebe verursacht natürlich starke Reibungen, durch welche auch eine deutliche Temperatursteigerung zustande kommen kann.

Die Geschwindigkeit v ist frequenzunabhängig, während die Beschleunigung g wächst mit steigender Ultraschallfrequenz und bei einer Ultraschallfrequenz von 3 MHz dreimal höher wird als bei 1 MHz. Bei 10 MHz erreicht sie sogar 7.250 km/s²!

$$v = (2I / \rho c)^{1/2}$$

$$g = 2\pi f (2I / \rho c)^{1/2}$$

DRUCK

Durch Ultraschallwellen werden im Gewebe auch abwechselnd Überdruck und Unterdruck entstehen. Für die oben genannten Parameter des Ultraschalls wird dieser Druck p den Wert von ca. 1,7 bar = 1,7x10⁵ Pa erreichen und ist damit fast doppelt so hoch wie der normale atmosphärische Druckwert. Der Unterdruck kann rein theoretisch auch einen Wert von -1,7 bar erreichen. Allerdings werden diese Werte von unten begrenzt. Bei Ultraschallintensität von 2 W/cm² werden diese Druckamplituden sogar das Dreifache des atmosphärischen Drucks erreichen.

Auf den ersten Blick scheint dies sehr überraschend zu sein, weil während einer Ultraschallbehandlung kaum etwas zu spüren ist. Eine Vakuummassage oder eine Vakuum-Kompressions-Massage mit einem Unter- oder Überdruckwert von nur 0,1 bar (ca. 10 % vom normalen atmosphärischen Druckwert) ist dagegen deutlich spürbar.

Bei einer Vakuum- bzw. Kompressions-Massage handelt es sich um eine oberflächliche Behandlungsmethode, bei welcher die Hautrezeptoren und die Durchblutung die entscheidende Rolle spielen. Der sich im Gewebe aufbauende Druck ist aber gar nicht so hoch wie man oft denkt. Beim Ultraschall ist dies anders: Die Hautrezeptoren sowie die Gefäßrezeptoren „sehen“ die Ultraschallwellen gar nicht und bleiben bei solcher Behandlung *inaktiv*. Die Druckwerte im Gewebe können aber lokal so hoch sein, dass man hier über eine richtige „Mikromassage“ sprechen kann.

Solch hohe Werte können das Gefühl erwecken, dass die externen Partikel durch aufgebauten Druck einfach in den Körper „eingedrückt“ werden können, was die Phonophorese erklären sollte. Dies ist nicht der Fall. Der oben genannte Druckwert ist *frequenzunabhängig*,

$$p = (2I\rho c)^{1/2}$$

d.h. er bleibt bei *jeder Ultraschallfrequenz gleich*. Dies widerspricht den Experimenten, welche eine deutliche *frequenzabhängige* Wirkung der Phonophorese zeigen.

Mechanische Effekte durch Druckvariationen in der Haut sollten beim konventionellen Ultraschall mit Frequenzen von 1 MHz und 3 MHz keine große Rolle spielen. Stratum Corneum ist ca. 15 µm dick und ist damit deutlich kleiner als die typische Halbwellenlänge des Ultraschalls bei 1 MHz (750 µm) oder bei 3 MHz (250 µm). Dies kann sich bei höheren Frequenzen ändern. Bei 10 MHz beträgt die Halbwellenlänge lediglich 75 µm, was die Gewichtung der mechanischen Effekte bei der Phonophorese deutlich erhöht und die Effektivität der Phonophorese bei diesen Frequenzen deutlich steigern kann.

Bedeutet diese Frequenzunabhängigkeit des Drucks tatsächlich, dass die *Druckstrukturen* im Gewebe gleich sind? Maximale Druckwerte sind tatsächlich frequenzunabhängig, die Druckverteilung ist aber sehr *frequenzabhängig*. Dafür gibt es einen sehr wichtigen Grund – die Wellenlänge, so heißt der Abstand zwischen zwei maximalen Werten in einer Welle, ist fest mit der Frequenz verbunden.

Die Wellenlänge des Ultraschalls mit Frequenz von 1 MHz ist ca. 1,5 mm; bei einer Frequenz von 3 MHz beträgt sie ca. 0,5 mm und bei 10 MHz liegt sie bei 0,15 mm. Dies bedeutet, dass bei Ultraschall mit einer Intensität von 1 W/cm² und einer Frequenz von 1 MHz der maximale Überdruck von 1,7 bar und der maximale Unterdruck von -1,7 bar räumlich lediglich durch die halbe Wellenlänge (ca. 0,75 mm) getrennt werden. Dadurch entsteht eine gigantische und sich

ständig verändernde lokale Druckdifferenz innerhalb von nur 0,75 mm. Beim Ultraschall mit einer Frequenz von 3 MHz wird diese Druckdifferenz in einem Raum von nur 0,25 mm und bei 10 MHz sogar innerhalb von nur 0,075 mm aufgebaut (siehe Abb.1). Im Gewebe entstehen dabei gigantische *Druckgradienten*.

LDM-METHODE

Wenn also die Ultraschallfrequenz bei gleicher Intensität von 1 MHz auf 3 MHz oder von 3 MHz auf 10 MHz geändert wird, bleiben die absoluten Druckwerte im Gewebe gleich. Die Größe jeder Mikromassage-Einheit wird dabei allerdings von 0,75 mm auf 0,25 mm (bzw. von 0,25 mm auf 0,075 mm) verkleinert. Dadurch entsteht eine einzigartige Möglichkeit, die Massage-Wirkungen des Ultraschalls dynamisch zu modulieren.

Diese Möglichkeit ergibt sich zum ersten Mal mit der Einführung der neuen *LDM-Technologie*. In dieser Technologie werden die Ultraschallfrequenzen mit großer Geschwindigkeit (zwischen 100 und 1000 Mal pro Sekunde) gewechselt. Dabei entsteht eine Pulsation von Druckgradienten im Gewebe mit gleicher Frequenz. Dies führt zu einer neuen Art der Mikromassage im Gewebe, welche bei einer konventionellen Ultraschallanwendung nicht existiert.

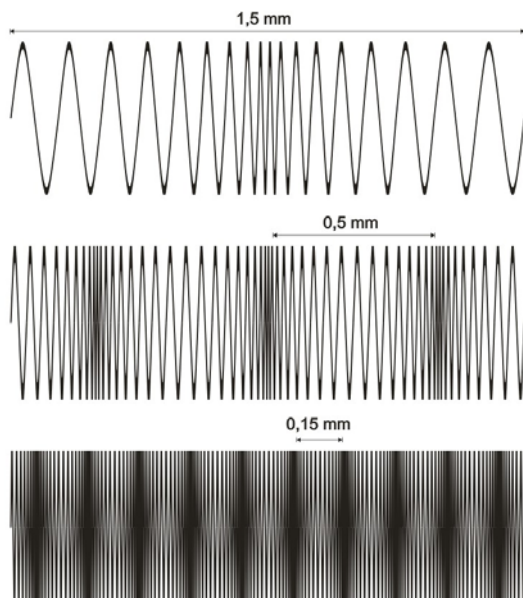


Abb. 1. Druckverlauf in Ultraschallwellen.
a) Frequenz 1 MHz, Wellenlänge 1,5 mm;
b) Frequenz 3 MHz, Wellenlänge 0,5 mm;
c) Frequenz 10 MHz, Wellenlänge 0,15 mm.

Bis jetzt könnte man die mechanische Wirkung nur durch eine *Intensitätsänderung* des Ultraschalls beeinflussen. Nach Abb. 2 kann dies wie eine *„vertikale“* Steuerung der Massage bezeichnet werden.

Mit der LDM-Methode kann der *Wirkungsraum der Massage*, dessen Größe durch elementare Zelle (Wellenlänge) bestimmt ist, verändert werden. Weil diese Veränderung in Richtung der Wellenrichtung stattfindet (s. Abb. 1), kann diese zusätzliche Möglichkeit als eine *„horizontale“* Steuerung der Massage bezeichnet werden.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Geschwindigkeit in einem Ultraschallfeld frequenzunabhängig ist und nur durch Ultraschallintensität beeinflusst werden kann. Die Amplitude und die Beschleunigung sind dagegen frequenzabhängig und können durch Intensität sowie durch Ultraschallfrequenz beeinflusst werden (Tabelle 1). Der Maximalwert des Drucks im Gewebe ist zwar frequenzunabhängig, die Druckverteilung kann allerdings durch Frequenz stark beeinflusst werden.

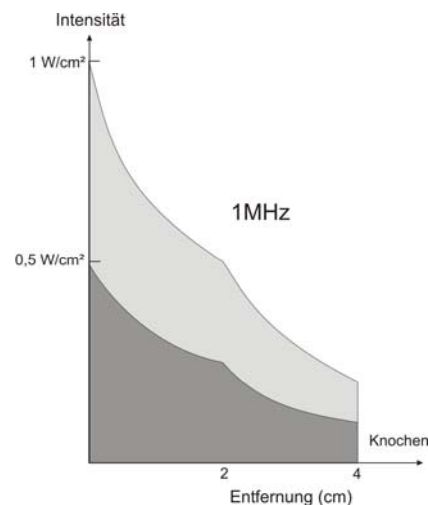


Abb. 2. Energieverteilung im Körper bei einer Ultraschallfrequenz 1 MHz und zwei verschiedenen Intensitäten auf der Haut. Durch Erhöhung der Intensität („vertikale“ Steuerung) können die Druckwerte im Gewebe entsprechend erhöht werden.

Tabelle 1

Physikalische Parameter von Ultraschallwellen mit verschiedenen Frequenzen

Parameter (max. Werte)	Frequenz 1 MHz, Intensität 1 W/cm ²	Frequenz 3 MHz, Intensität 1 W/cm ²	Frequenz 10 MHz, Intensität 1 W/cm ²
Amplitude	0,018 µm	0,006 µm	0,0018 µm
Geschwindigkeit	0,115 m/s	0,115 m/s	0,115 m/s
Beschleunigung	725 km/s ²	2.175 km/s ²	7.250 km/s ²
Druck	1,7 bar	1,7 bar	1,7 bar
Halbwertstiefe, 50 %	ca. 3 cm	ca. 1 cm	ca. 0,3 cm
Eindringtiefe, 10 %	ca. 6 cm	ca. 2 cm	ca. 0,6 cm

EINDRINGTIEFE DES ULTRASCHALLS

Wie tief und mit welcher Intensität der Ultraschall in den Körper eindringt, ist *frequenzabhängig*. Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine Penetrationstiefe des Ultraschalls zu definieren. Eine davon ist die so genannte *Halbwertstiefe* – die Strecke, nach der sich die Schallintensität auf 50 % reduziert. Dieser Parameter bleibt gleich, unabhängig davon, welche Intensität am Gerät eingestellt wurde. Eine andere Definition ist die so genannte *Eindringtiefe* – die Strecke, nach der sich die Schallintensität auf ca. 10% des Ursprungswertes reduziert hat.

Zum Beispiel beträgt die Halbwertstiefe (Eindringtiefe) für den Ultraschall mit einer Frequenz von 1 MHz ca. 3 cm (6 cm) bei einer normalen Körperkonstitution; für eine Ultraschallfrequenz von 3 MHz ist dieser Wert fast drei mal kleiner und beträgt somit ca. 1 cm (2 cm). Für Ultraschall mit einer Frequenz von 10 MHz liegen diese Werte bei ca. 0,3 cm (0,6 cm). Je niedriger die Ultraschallfrequenz ist, desto tiefer dringt er in den Körper ein. Dabei wird fast die ganze Energie nicht in den Hautstrukturen, sondern erst in Subkutis, Muskeln und Knochen absorbiert oder reflektiert. Für oberflächliche Anwendungen (besonders für Dermatologie und Kosmetik) dürfte der Ultraschall mit einer Frequenz von 10 MHz wegen seiner Absorption in der Haut von Vorteil sein.

Nehmen wir an, die Ultraschallintensität beträgt an der Haut 1 W/cm². Dann wird im Körper die Intensität von 0,5 W/cm² in der Tiefe von ca. 3 cm bei 1 MHz und in der Tiefe von ca. 1 cm bei 3 MHz registriert (Tabelle 2). Wird an der Oberfläche eine Intensität von 2 W/cm² eingesetzt, werden die oben genannten Tiefen durch eine Ultraschallwelle mit einer Intensität von 1 W/cm² erreicht. Dies bedeutet, dass die anfängliche Ultraschallintensität bei einer fixierten Ultraschallfrequenz immer in der gleichen Tiefe im Körper *halbiert* wird, obwohl die *absoluten* Ultraschallwerte in dieser Tiefe unterschiedlich werden. Dies kann mit Abb. 2 und 3 deutlich illustriert werden.

Wird die Ultraschallenergie schnell auf der Strecke bleiben, entsteht eine schnellere Erwärmung im oberflächlichen Bereich des Körpers.

Werden allerdings die Frequenzen 1 MHz und 3 MHz schnell abwechselnd benutzt (wie es der Fall bei der LDM-Methode ist), besteht die Möglichkeit, die Energieverteilungen zwischen zwei Grenzkurven (1 und 3 MHz) zu erzielen (s. Abb. 3). Dies eröffnet den Weg zu einer effektiveren *großvolumigen* Behandlung, welche an ein „Bügeln“ erinnert. In der Kosmetik ist dies besonders bei der Cellulite interessant. Wird diese Technologie für Frequenzen 3 und 10 MHz benutzt, kann diese „Bügelmethode“ bei oberflächlichen Indikationen vorteilhaft eingesetzt werden.

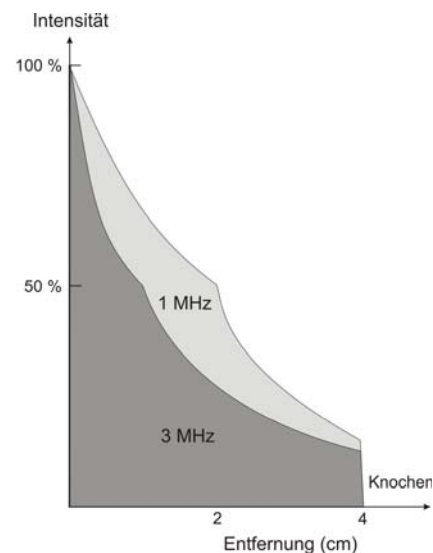


Abb. 3. Energieverteilung im Körper für Ultraschallfrequenzen 1 MHz und 3 MHz. Die Intensität auf der Haut ist bei beiden Frequenzen gleich und beträgt 100 %. Man sieht, dass auf dem Weg zum Knochen viel mehr Energie bei 3 MHz als bei 1 MHz absorbiert wird. Ein schneller Wechsel zwischen 1 MHz und 3 MHz führt zu einem „Bügeln“ zwischen zwei Grenzkurven.

Tabelle 2

Vergleich von Ultraschallwellen mit Frequenzen 1 MHz und 3 MHz

Parameter (max. Wert)	Ultraschallfrequenz 1 MHz			Ultraschallfrequenz 3 MHz		
	0 cm	2 cm	6 cm	0 cm	2 cm	6 cm
<i>Amplitude</i>	0,0184 μm	0,0146 μm	0,0058 μm	0,0061 μm	0,0031 μm	0,0008 μm
<i>Geschwindigkeit</i>	0,115 m/s	0,091 m/s	0,036 m/s	0,115 m/s	0,058 m/s	0,014 m/s
<i>Beschleunigung</i>	725 km/s^2	576 km/s^2	229 km/s^2	2175 km/s^2	1090 km/s^2	274 km/s^2
<i>Druck</i>	1,70 bar	1,35 bar	0,54 bar	1,70 bar	0,85 bar	0,21 bar

Vergleich von Ultraschallwellen mit Frequenzen 3 MHz und 10 MHz

Parameter (max. Wert)	Ultraschallfrequenz 3 MHz			Ultraschallfrequenz 10 MHz		
	0 cm	0,5 cm	1 cm	0 cm	0,5 cm	1 cm
<i>Amplitude</i>	0,0061 μm	0,0051 μm	0,0043 μm	0,0018 μm	0,0010 μm	0,0008 μm
<i>Geschwindigkeit</i>	0,115 m/s	0,097 m/s	0,081 m/s	0,115 m/s	0,065 m/s	0,049 m/s
<i>Beschleunigung</i>	2175 km/s^2	1830 km/s^2	1538 km/s^2	7250 km/s^2	4075 km/s^2	3077 km/s^2
<i>Druck</i>	1,70 bar	1,43 bar	1,20 bar	1,70 bar	0,96 bar	0,72 bar

ZUSAMMENFASSUNG

Die LDM-Technologie bietet drei Vorteile gegenüber der konventionellen Anwendung des Ultraschalls.

- Vorteil 1.** Ein schneller Wechsel von Ultraschallfrequenzen führt zu einer starken Pulsation von Druckgradienten im Gewebe, was eine neue Art von innerer Mikromassage hervorruft.
- Vorteil 2.** Die Anwendung der LDM-Technologie bietet zusätzlich die Möglichkeit, eine großvoluminöse Gewebsbehandlung durchzuführen.
- Vorteil 3.** Die LDM-Technologie verspricht große Vorteile, wenn verschiedene Frequenzen unterschiedliche Wirkungen haben, welche in einer Behandlung kombiniert werden müssen.

Einige Beispiele für die Anwendung der LDM-Technologie in der Ästhetik sind

- **Hautverjüngung**
Durch eine Differenzierung von Fibrozyten in die Fibroblasten.

- **Straffung**
Durch Verbesserung der Kollagenorganisation, Erhöhung des Turgors und Vergrößerung von extrazellulären Räumen.
- **Cellulite**
Durch Verbesserung der Bindegewebsstrukturen, Beschleunigung der Diffusionsvorgänge mit entsprechender Erhöhung des Stoffwechsels im Fettgewebe.
- **Stimulation von Bindegewebe**
Produktion von so genanntem fibroblast-stimulierenden Faktor von Makrophagen wird durch Ultraschall mit einer Frequenz von 3 MHz stärker angeregt. Gleichzeitig wird die Freisetzung von diesem Faktor durch Ultraschall mit einer Frequenz von 1 MHz besser stimuliert. Erst eine Kombination von verschiedenen Frequenzen in einer Behandlung kann beide Prozesse optimal steuern.
- **Narben und Aknenarben**
Durch Veränderung der Kollagenetzstrukturen, Verbesserung der Mikrozirkulation und des Stoffwechsels.

WELLCOMET GmbH
Junkersring 28
D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Telefon: 0721/8 93 56-0
Fax: 0721/8 93 56-90
E-mail: info@wellcomet.de
www.welloomet.de


Überzeugend anders!